



التاريخ : ٤.٧.٢٠١٨


الرقم: .....

تنويه بخصوص مناقصة رقم MOH-GSD/MOFP/2018/123 " شراء وتوريد وتركيب

أجهزة طبية لمشروع تشطيب طوارئ مستشفى رفيديا - نابلس لصالح وزارة الصحة

بناء على بعض الاستفسارات التي وردتنا على المناقصة المذكورة اعلاه، مرفق لكم ملخص لهذه الاستفسارات والردود عليها، ويعتبر هذا التنويه جزء من وثائق المناقصة ويجب على جميع الشركات ارفاقه مع كراسة المناقصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

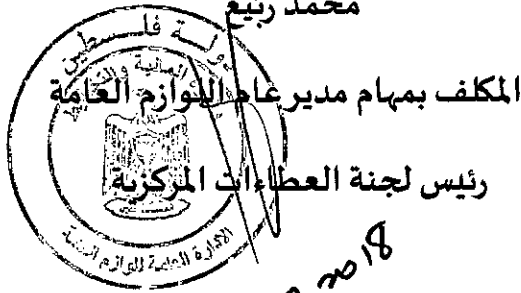

محمد ربيع

المكلف بمهام مدير عام الادارة العامة

رئيس لجنة العطاءات المركزية

٤.٧.٢٠١٨



التاريخ : .....

الرقم: .....

• بخصوص البنود والشروط العامة للمناقصة :

1- بخصوص مدة التوريد المذكورة في المناقصة وهي 90 يوما ، يمكن زيادة هذه الفترة للبند رقم 5 (Digital Radiography system) و للبند رقم 13 (Whole body Multi slice CT Scanner (128 slices))

لتصبح 120 يوما كحد أقصى.

2- يجب الإلتزام بالعملة الواردة في وثائق العطاء وهي الشيكل.

• بخصوص المواصفات الفنية:

• البند رقم 2 (Bedside Monitor) : حجم الشاشة المطلوب : يجب الإلتزام بالحجم المذكور في المواصفات المطروحة في العطاء وهو 17". أما بخصوص البطارية المطلوبة للشاشة ، تستطيع الشركات المشاركة في العطاء تقديم شاشات لا تحتوي على بطارية - للشاشة - على أن يكون هناك شكل ما من أشكال البطاريات في الوحدات الخاصة بقياس الإشارات الحيوية للمريض (Parameter Modules) وذلك لضمان استمرار مراقبة المريض وحفظ المعلومات في حالات نقل المريض من مكان لآخر وحالات انقطاع التيار الكهربائي ...

• بخصوص البند رقم 13 (Whole body Multi slice CT Scanner (128 slices)):

1. Under the warranty & CAMC : فإن كفالة الجهاز يجب أن تشمل جميع مكونات وملحقات الجهاز (بما فيها الانبوب) التي تم ذكرها في هذا البند للفترة المطلوبة (5 سنوات).

- ويجب أن يكون العرض المقدم يحتوي على سعر منفصل لعقد الصيانة السنوي الخاص بالجهاز وثابت لمدة 5 سنوات بعد مدة الكفالة المطلوبة، علما أنه سيتم أخذ سعر هذا العقد بعين الإعتبار أثناء عملية التقييم.

- وبخصوص سعر انبوب الأشعة (X-ray Tube) فإنه يجب الألتزام بتسعيه بشكل منفصل للمدة المطلوبة وهي خمس سنوات بعد مدة الكفالة الرئيسية.



4.7.2018



التاريخ : .....

الرقم: .....

2. Under the training requirements : بخصوص متطلبات التدريب:

(a) تدريب الطاقم الطبي

- طبيب واحد فقط: الرجاء تسعير التدريب بشكل منفصل على ان يكون التدريب متخصص في Cardiac Applications ولمدة اسبوع.
- فني أشعة واحد فقط : الرجاء تسعير التدريب بشكل منفصل على ان يكون التدريب متخصص في Cardiac Scanning ولمدة اسبوع.

- (b) تدريب مهندس صيانة : لا حاجة لتدريب مهندس ، لأن صيانة هذه الأجهزة يعتمد نظام عقود الصيانة السنوية مع الشركات الموردة.

3. بخصوص low contrast Resolution نود توضيح مايلي :

- A table of low contrast for different objects sizes should be submitted. And for the object at least 4mm which mentioned in specs at 3% the mGy should be 20 mGy (2 rads) or less.

4. بخصوص ال ECG Gated scan :

The offer should be included both Prospective and Retrospective cardiac scanning

5. بخصوص ال Dose reduction technology :

سيتم اعتماد ال Model Base Iterative Dose Reduction (MBIDR) في الدراسة الفنية.

6. بخصوص مواصفة Independent work station :

- The offer should include only the main console with all clinical application softwares that mentioned in the tender's specs
- Regarding the requested independent workstation, Must be identical with the main console of the same supplier of CT, and should be priced separately. (The price will not be taken into consideration in the evaluation of the tender)



4.7.2018